

Anker[®]
Implant

BONE LEVEL
Pterygoid Implant


Digitalization



 **alliance**



獲獎實績

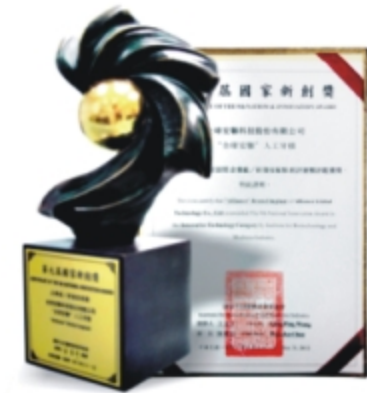

2012年
國家新創獎



2013年
MIT植體磐石獎
「優石獎」



2018年
台灣金根獎



2021年
台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE



2024年
藥物科技研究發展獎
製造技術類-銀質獎



2025年
台灣金根獎



高雄醫學大學、台北醫學大學、中山醫學大學、高雄榮民總醫院
成大醫院、若瑟醫院、大同醫院、慈濟醫院
等各大醫院使用Anker植體



Anker系列植體選用來自美國符合ASTM F67-06與F136-08標準的材料，其抗張强度高於標準35%，且通過各項生物相容性的測試。

材料生產國：美國



Implant

BONE LEVEL

Narrow

Standard




SB - I
System

D: Ø3.4~Ø4.8
L: 7~15



SB - II
System

D: Ø3.0~Ø7.0
L: 7~15

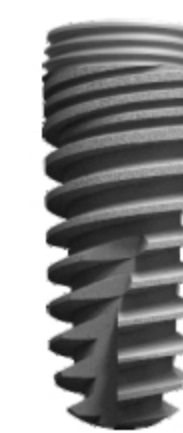

SB - III
System

D: Ø3.5~Ø5.0
L: 7~15



New

BA - 5
System

Pterygoid
D: Ø3.5 & Ø4.0
L: 8.5~21

ONE - PIECE



MIP
System

Post type




MIB
System

Ball type



Bone Level Taper Kit

GBR series

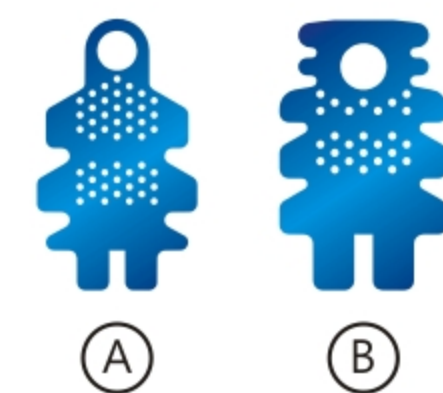

(A)



(B)



(C)



(D)




(H)

規格35x55mm

實際厚度小於0.05mm




Fixing Screw Bone Tack

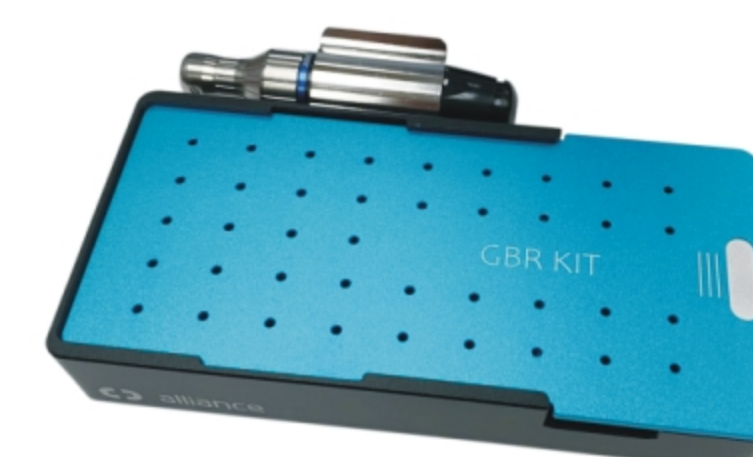

Tack / Fixing Kit

All-On-X

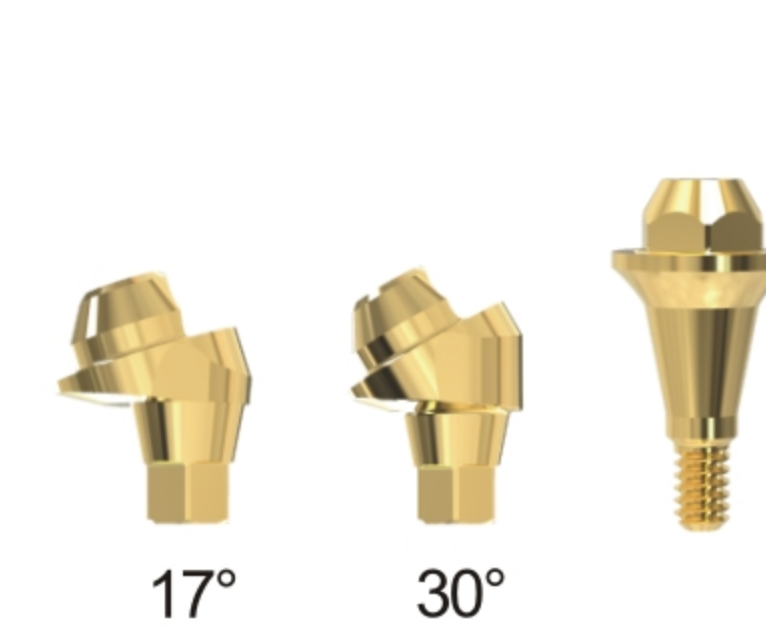

17°

30°



Digitalization



Surgical Guide Kit

Tony Cap



BA5 Surgical Kit